

MEDVIE


Date du test: 10/09/2024 20:34:33

Durée: 3mn 20s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KONDE CYRILLE	
Date de naissance	01/01/1984
Age	40
Société	GUIISOFTLAB
ID	24091020325090331

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

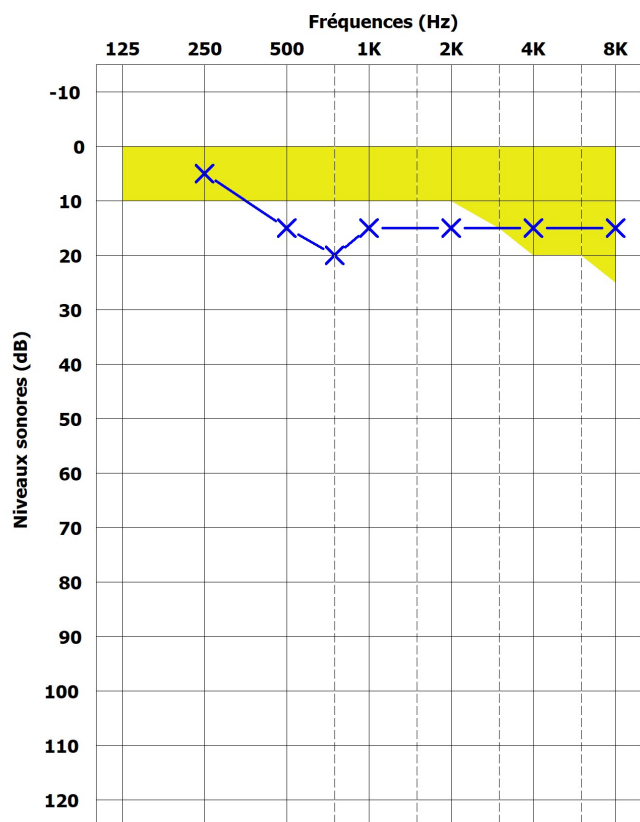

Oreille Gauche

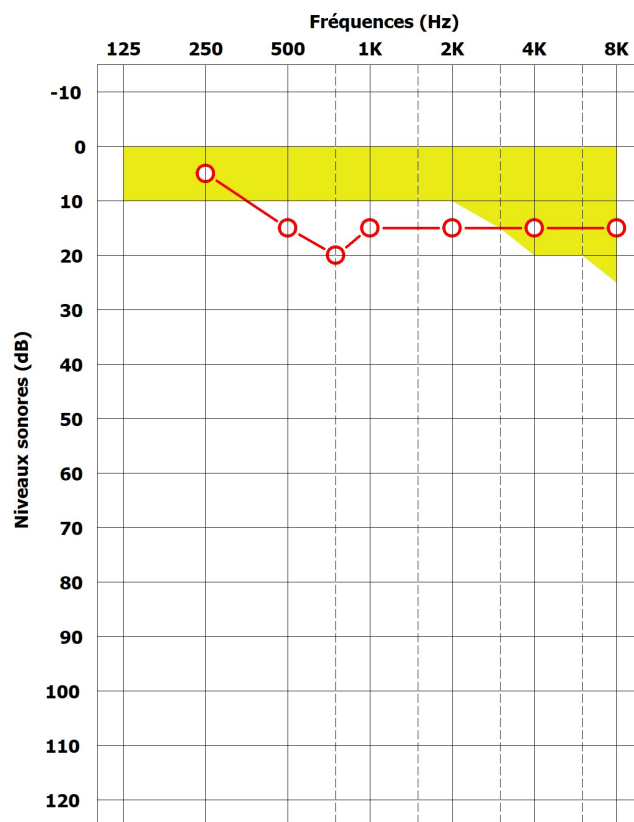

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	20	15		15		15		15
CA Droit		5	15	20	15		15		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes